


**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД /СБАЛОЗ/**

1233 гр.София, бул.”Столетов” №67,тел.: 02/801 39 22, тел./факс: 02/832 11 56,

E-mail: odozs_sofia_obl@abv.bg

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

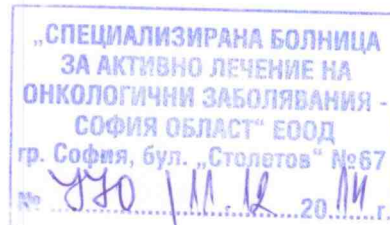

Относно: Искане за разяснения по реда на глава осма „а”, от Закона за обществените поръчки в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Доставка и монтаж на парафинов микротом и парафинов център за нуждите СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по реда на глава осма „а”, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП Ви предоставям следните разяснения по обществена поръчка чрез публична покана с ID № 9037149 в РОП от 08.12.2014 г. с предмет: **„Доставка и монтаж на парафинов микротом и парафинов център за нуждите СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД“**

Въпрос № 1:

За Полуавтоматичния микротом сте заложили изискване за 3 скорости на подаване на материала с управление само от един бутон, докато при предлагания от нас модел скоростта се определя от желанията и уменията на лаборанта постепенно, съответно с два бутона/стрелки на мембранната клавиатура (увеличение/намаление)!

Отговор № 1:

Трите скорости на подаване с един бутон улесняват работата и не изискват специални умения на лаборанта (или лаборантите) за регулиране на скоростта на подаване.

Въпрос № 2:

За Полуавтоматичния микротом сте заложили изискване за Сваляем дисплей, който да се ползва от двете страни на апарата, докато при нас има един екран за управление на самия апарат и втори допълнителен дистанционен, който може да се ползва от ляво или дясно на апарата.

Отговор № 2:

За удобство при работа и настройване на апарата от двете му страни в зависимост от организацията на работното място на лаборанта.

В един дисплей за управление са събрани всички функции по наблюдение и команди при работа на уреда.

Въпрос № 3:

За Парафиновия център сте заложили в техническата спецификация изискване за 5 литра резервоар за парафина, докато при предлагания от нас модел резервоарът за Парафин е с вместимост от 4 литра. При предлагания от нашия производител модел е внедрена патентована система за подгряване на парафина, която позволява до 30% по-бързо топене на парафина (максимум до 3 часа при пълно зареждане). По малкия обем дава възможност за по-компактни размери на апарата, което би имало предимство при ограничени пространства в лабораторията.

Отговор № 3:

Пет-литровият резервоар осигурява по-продължителна непрекъсната работа при едно зареждане с парафин и не изисква допълнително работно пространство за разполагане на уреда.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ДИАНА ЙОРДАНОВА

УПРАВИТЕЛ

